


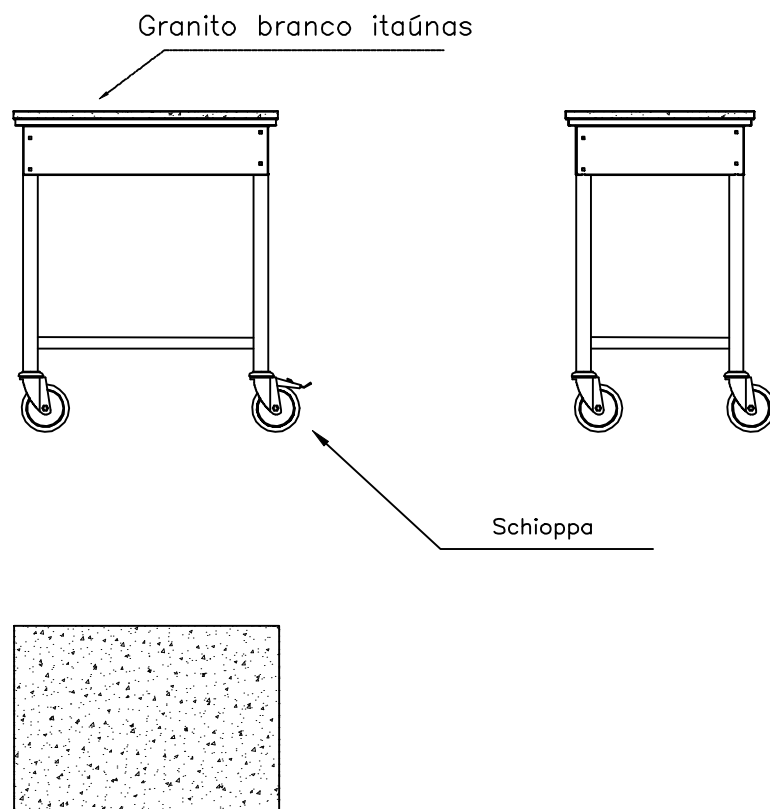

CONSTRUÇÃO:

Estrutura em aço inox e tampo em granito Branco Itaúnas.

Provida de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo os quatro com travas.

Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox.

O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado.

Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento. Nos quatro cantos prever cantoneira em aço inox com altura igual à espessura da pedra para proteção do granito. Com 02 prateleiras inferiores recuadas da parte frontal. P=500 mm Dimensão: 1600 x 800 x 900 mm



CLIENTE: SENAC SP

DESCRIÇÃO: MESA LISA DE CENTRO COM RODAS

LOTE: 29

ITEM: 64-M11

QTD.: 06

PROJ.:
TOPEMA

ESCALA:
S/ESC

DES.:
TOPEMA

DATA:
13/02/2025

DESENHO N

REV.
R02